

MANUAL DE USUARIO

Cama Stella

Loja Ortopédica®

Manual de instrucciones de montaje elaborado por el fabricante con el objetivo de facilitar la comprensión del uso y montaje del producto.

Si, después de leer íntegramente este material, todavía tiene alguna duda sobre el montaje o el uso de la cama, póngase en contacto con Loja Ortopédica.

Producto distribuido por:

HappyLife - Prod.Ortoped.e Cirurg., Unip., Lda
(Loja Ortopedica)

Tienda física
Av. Nossa Senhora de Fátima, 28, Loja B, 2410-140, Leiria

Tienda online
R. Dr. Arnaldo Cardoso e Cunha, 36, R/C Esquerdo, 2410-270,
Leiria

T: (+351) 244 233 085 | E: info@lojaortopedica.pt

Introducción

Este manual ha sido elaborado teniendo en cuenta al usuario/paciente, con información sencilla, para que la cama modelo STELLA, destinada a los cuidados domiciliarios, responda de la mejor manera a las necesidades del usuario/paciente. Todas las referencias de esta cama, incluida la versión Light, incluyen los movimientos indicados en la página 4 de este manual. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual para garantizar la seguridad del usuario/paciente, así como la vida útil de la cama (5 años si se utiliza correctamente de acuerdo con las indicaciones de este manual).

Siempre que sea necesario referirse a la adquisición de accesorios/piezas para la cama utilizando el lado izquierdo o derecho, hágalo tomando como referencia la posición de una persona tumbada boca arriba, con la cabeza junto al respaldo/cabecero de la cama.

Este manual se aplica a los productos con las siguientes referencias:

Ref.ª	ESTRUCTURA	SOMIER	CABECEROS Y BARANDILLAS		Patas c/ 4 ruedas Ø100 mm c/ freno	Peso (Kg)
	Acero Pintura Epoxi	Lamas Haya	Versión estándar	Versión Light		
10.CM.6099	V	V	Con barandillas		V	56
10.CM.6099.1			Sin barandillas			
10.CM.6099.2				Con barandillas		
10.CM.6099.3				Sin barandillas		





Uso previsto

La cama Stella ha sido diseñada para el descanso del paciente en cuidados domiciliarios, favoreciendo la máxima autonomía. Es adecuada para el tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o discapacidad. El modelo Stella ha sido diseñado teniendo en cuenta la norma EN 60601-2-52 relativa a la seguridad de las camas eléctricas y sus barandillas.

CUIDADOS E INDICACIONES IMPORTANTES

ATENCIÓN: No utilice esta cama como carro de transporte ni como camilla. A pesar de todas las precauciones e indicaciones del fabricante, se apela al sentido común y a las buenas prácticas de los usuarios, siguiendo las indicaciones del personal médico o del cuidador al utilizar la cama según el estado psicomotor y la morfología del usuario/paciente, valorando si su uso es adecuado con el fin de prevenir riesgos. Por ejemplo, las posiciones Trendelenburg y Anti-Trendelenburg solo deben utilizarse bajo indicación o supervisión médica.

- La cama Stella se suministra acondicionada en posición vertical (mediante el Kit de Transporte) para facilitar el transporte y el almacenamiento; únicamente requiere un montaje final en las instalaciones del cliente. Véase el esquema 1.
- La cama Stella debe utilizarse para el fin para el que ha sido diseñada.
- La cama Stella está preparada para un solo paciente cada vez (de 12 años o más) con un peso de hasta 135 kg. Peso máximo admisible (paciente + accesorios): 170 kg.
- Antes de colocar al paciente en la cama, asegúrese de que la estructura esté correctamente instalada/montada.
- Compruebe que no haya muebles u objetos alrededor de la cama que puedan interferir con su funcionamiento, articulación o elevación en altura al accionar las funciones mediante el mando.
- En caso de un paciente encamado, compruebe SIEMPRE y GARANTICE una altura mínima de 220 mm entre el colchón y la barandilla/cabecero/piecero, con el fin de evitar caídas si el paciente se mueve. Del mismo modo, para minimizar el riesgo de caída del paciente, la cama debe mantenerse siempre a la altura mínima.
- La cama/plataforma debe ajustarse a la altura del paciente para facilitar la entrada y salida.
- Se recomienda un colchón sencillo de baja densidad con 6 cortes (1820 x 890 x 100 mm), con funda impermeable e ignífuga y cremallera en L (10.AC.1039). No debe utilizarse un colchón de más de 150 mm de grosor.

CUIDADOS DEL MOTOR Y DEL MANDO

Elevar el segmento del respaldo

Elevar el segmento de los pies

Elevar simultáneamente los segmentos del respaldo y de los pies

Elevar el motor del cabecero a la posición Anti-Trendelenburg y bajar el motor del piecero



Bajar el segmento del respaldo

Bajar el segmento de los pies

Bajar simultáneamente los segmentos del respaldo y de los pies
Bajar la plataforma de la cama

Bajar el motor del cabecero desde la posición Anti-Trendelenburg y elevar el motor del piecero

Foto 1

- 3 motores y un mando realizan la articulación de la plataforma y su elevación en altura. Deben permanecer conectados a la red eléctrica para un funcionamiento continuo. Para garantizar este funcionamiento, la cama puede equiparse opcionalmente con una batería para utilizarla en caso de corte de suministro eléctrico.
- Para retirar un motor (en caso de sustitución), basta con retirar los 2 tornillos que lo fijan a la estructura de la cama.
- Evite derramar líquidos sobre el motor y el mando.
- Los motores cumplen los requisitos de las directivas comunitarias relativas a compatibilidad electromagnética y baja tensión, y el nivel de ruido es <70 dB(A) (indicación del fabricante).
- Los motores disponen de marcado CE y una garantía de 2 años frente a defectos de fabricación demostrados. Esta garantía no cubre daños causados por una manipulación incorrecta del motor, cable, mando o enchufe, ni por incumplir las indicaciones de montaje en la estructura del sistema elevador y el somier.
- Al final de su vida útil, el motor eléctrico debe entregarse a una entidad autorizada para la eliminación de residuos conforme a la legislación vigente.
- La cama debe utilizarse únicamente en interiores, nunca en exteriores ni al aire libre.

Después de retirar el embalaje, compruebe todos los componentes y, si es necesario, realice el montaje de acuerdo con las instrucciones.

CONEXIÓN DE LOS MOTORES Y DEL MANDO

Conectar motor de elevación del piecero

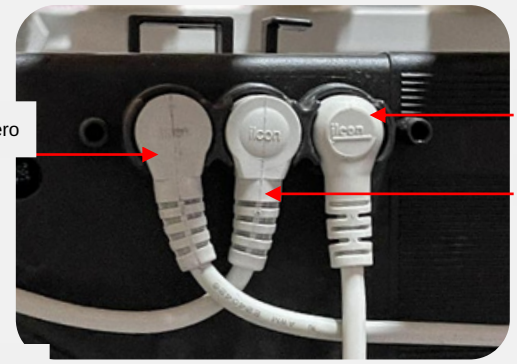

Conectar mando

Conectar motor de elevación del cabecero

Foto 2

POSICIONES POSIBLES DE LA CAMA

Altura mínima - 350 mm



Altura máxima - 750 mm



Anti-Trendelenburg



Trendelenburg



Posición sentada



Posición tumbada



Respaldo elevado



Posición vascular



Instrucciones de montaje

Esquema 1

1

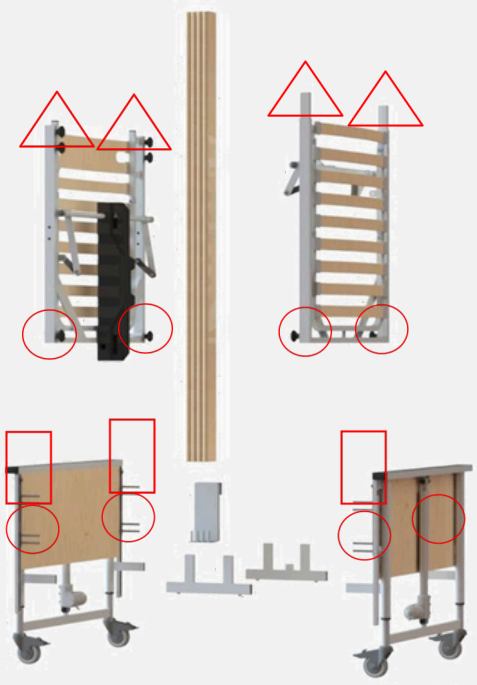

Paso 1
Retire el embalaje y las piezas 1, 2, 3 y 4. Coloque estas piezas en el alojamiento correspondiente situado debajo del somier, junto al cabecero.

Paso 2
Retire las 4 piezas del Kit de Transporte.

Paso 3
Una las 2 partes señaladas del somier.

Introduzca los tubos rectangulares de los cabeceros en los extremos señalados del somier.

Introduzca los 16 casquillos redondos en las 4 lamas señaladas de las barandillas.

ATENCIÓN: observe la posición de los orificios de las barandillas; consulte el Esquema 2 de esta página.

Paso 4
Ajuste las barandillas, el somier y los cabeceros apretando los respectivos mandos de fijación.

Paso 5
Compruebe el correcto funcionamiento de las barandillas.

Paso 6
Compruebe el correcto funcionamiento de las barandillas. Conecte el enchufe del motor a la red eléctrica y compruebe el funcionamiento del motor, las articulaciones/elevación y las demás funciones de la cama.

Esquema 2





Dimensiones - kit de transporte (en milímetros)

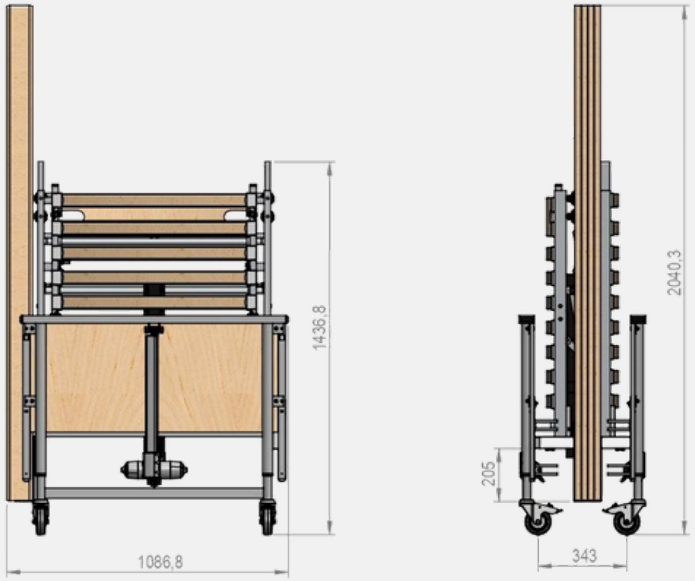

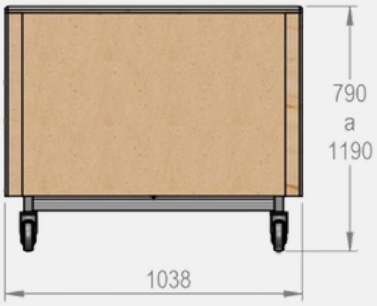

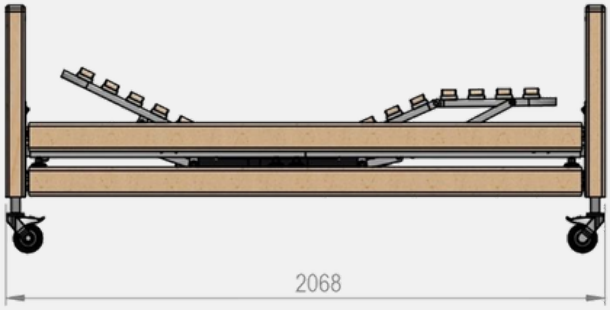

Preste atención al posible riesgo de aplastamiento de dedos o manos en las partes móviles:

- Entre el cabecero cuando se articula y la estructura.
- Entre las 4 partes de la plataforma y el soporte del somier.
- En el espacio entre las 4 partes de la plataforma.



Preste especial atención a este símbolo. Está situado junto a las zonas de contacto entre dos superficies, donde puede producirse aplastamiento debido al movimiento de las secciones articuladas si los dedos o las manos se encuentran en la zona de contacto.

Funcionamiento de las barandillas

Para bajar la barandilla, alivie ligeramente la barandilla superior y pulse el botón situado en el canal/perfil del cabecero, haciendo que la barandilla se deslice hacia abajo.
Para subir las barandillas, basta con levantar la barandilla superior hasta oír un "clic".

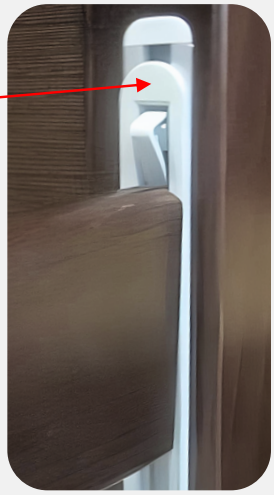



Limpieza y mantenimiento

- Para limpiar, utilice un paño suave y húmedo y, a continuación, pase un paño seco.
- Durante la limpieza, no utilice detergentes ni materiales que puedan dañar o rayar el producto.
- Para las operaciones de limpieza y desinfección se recomienda utilizar un producto adecuado para la limpieza y desinfección de dispositivos médicos. La frecuencia de limpieza deberá determinarse en función de las necesidades, del lugar donde se encuentre la cama y de la frecuencia de uso.
- No utilice nunca estaciones de lavado automático, lavado en túnel, agua a alta presión ni pulverizadores líquidos durante la limpieza. Existe riesgo de dañar el acabado o la pintura.
- No utilice disolventes como benceno, alcohol o sustancias similares.

Embalaje y almacenamiento

La cama Stella se suministra acondicionada en un Kit de Transporte, embalada en film o cartón. Solo es necesario retirar el embalaje y realizar el montaje final de acuerdo con el esquema anterior.
Debe almacenarse en lugares con temperatura y humedad controladas (temperatura inferior a 25 °C y humedad inferior al 60 %) para evitar daños en el embalaje o el producto.
Debe protegerse de posibles caídas de objetos, almacenarse en posición vertical y no debe apilarse.

JMS no asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso incorrecto, el incumplimiento de estas u otras indicaciones o la negligencia en el uso y manipulación del producto.

JMS se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación en el diseño, la funcionalidad, la estética y la comercialización de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso, así como a actualizar este manual siempre que sea necesario.

Protección del medio ambiente (eliminación y reciclaje)

JMS se preocupa por la preservación del medio ambiente en todo lo que hace. Le solicitamos que:
- Separe los residuos del embalaje y deposítelos en los puntos de reciclaje correspondientes o entréguelos a operadores autorizados.
- Al final de su vida útil, entregue el producto a un operador autorizado.
- No deseche el producto junto con los residuos domésticos comunes.

¡Gracias por su colaboración!

