

MANUEL D'UTILISATION

Lit Stella

Loja Ortopédica®

Manuel d'instructions de montage élaboré par le fabricant afin de faciliter la compréhension de l'utilisation et du montage du produit.

Si, après avoir lu intégralement ce document, vous avez encore des questions concernant le montage ou l'utilisation du lit, veuillez contacter Loja Ortopédica.

Produit distribué par :

HappyLife - Prod.Ortoped.e Cirurg., Unip., Lda
(Loja Ortopédica)

Magasin physique
Av. Nossa Senhora de Fátima, 28, Loja B, 2410-140, Leiria

Boutique en ligne
R. Dr. Arnaldo Cardoso e Cunha, 36, R/C Esquerdo, 2410-270,
Leiria

T : (+351) 244 233 085 | E : info@lojaortopedica.pt

Introduction

Ce manuel a été élaboré en tenant compte de l'utilisateur/patient, avec des informations simples, afin que le lit modèle STELLA, destiné aux soins à domicile, réponde au mieux aux besoins de l'utilisateur/patient. Toutes les références de ce lit, y compris la version Light, incluent les mouvements indiqués à la page 4 de ce manuel.
Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel afin de garantir la sécurité de l'utilisateur/patient ainsi que la durée de vie utile du lit (5 ans en cas d'utilisation correcte conformément aux indications du présent manuel).

Lorsque vous devez vous référer à l'achat d'accessoires/pièces pour le lit en utilisant son côté gauche ou droit, faites-le en vous plaçant dans la position d'une personne allongée sur le dos, la tête du côté du dossier/de la tête de lit.

Ce manuel s'applique aux produits portant les références suivantes :

<table>
<tr><th rowspan="2">Réf.</th><th>STRUCTURE</th><th>SOMMIER</th><th colspan="2">TÊTES DE LIT ET BARRIÈRES</th><th rowspan="2">Pieds avec 4 roulettes Ø100 mm avec frein</th><th rowspan="2">Poids (kg)</th></tr>
<tr><th>Acier peint époxy</th><th>Lattes en hêtre</th><th>Version standard</th><th>Version Light</th></tr>
<tr><td>10.CM.6099</td><td rowspan="4">V</td><td rowspan="4">V</td><td>Avec barrières</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="4">V</td><td>56</td></tr>
<tr><td>10.CM.6099.1</td><td>Sans barrières</td><td></td></tr>
<tr><td>10.CM.6099.2</td><td rowspan="2"></td><td>Avec barrières</td><td></td></tr>
<tr><td>10.CM.6099.3</td><td>Sans barrières</td><td></td></tr>
</table>





Usage prévu

Le lit Stella a été conçu pour le repos du patient dans le cadre de soins à domicile, en favorisant une autonomie maximale. Il convient au traitement ou au soulagement d'une maladie, d'une lésion ou d'un handicap. La conception du modèle Stella tient compte de la norme EN 60601-2-52 relative à la sécurité des lits électriques et de leurs barrières.

PRÉCAUTIONS ET INDICATIONS IMPORTANTES

ATTENTION : N'utilisez pas ce lit comme chariot de transport ou brancard. Malgré toutes les précautions et recommandations du fabricant, il est demandé aux utilisateurs de faire preuve de bon sens et de respecter les bonnes pratiques, en suivant les indications du personnel médical ou de l'aidant lors de l'utilisation de ce lit en fonction de l'état psychomoteur et de la morphologie de l'utilisateur/patient, afin d'évaluer si son utilisation est adaptée et de prévenir les risques. Par exemple, les positions Trendelenburg et Anti-Trendelenburg ne doivent être utilisées que sur indication ou sous surveillance médicale.

- Le lit Stella est fourni conditionné en position verticale (à l'aide du kit de transport) afin de faciliter le transport et le stockage ; seul un montage final est nécessaire chez le client. Voir schéma 1.
- Le lit Stella doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Le lit Stella est prévu pour accueillir un seul patient à la fois (âgé de 12 ans ou plus) pesant jusqu'à 135 kg. Poids maximal admissible (patient + accessoires) : 170 kg.
- Avant d'installer le patient dans le lit, assurez-vous que la structure est correctement installée/montée.
- Vérifiez qu'aucun meuble ou objet autour du lit ne puisse gêner son fonctionnement, son articulation ou son réglage en hauteur lorsque vous actionnez les fonctions à l'aide de la commande.
- Pour un patient alité, vérifiez TOUJOURS et GARANTISSEZ une hauteur minimale de 220 mm entre le matelas et la barrière/tête de lit/pied de lit afin d'éviter les chutes si le patient bouge. De même, pour réduire le risque de chute, le lit doit toujours être maintenu à sa hauteur minimale.
- Le lit/plan de couchage doit être réglé à la hauteur du patient pour faciliter l'entrée et la sortie du lit.
- Il est recommandé d'utiliser un matelas simple de faible densité avec 6 découpes (1820 x 890 x 100 mm), muni d'une housse imperméable et ignifuge avec fermeture éclair en L (10.AC.1039). Ne pas utiliser de matelas de plus de 150 mm d'épaisseur.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE MOTEUR/LA COMMANDE



Relever le segment du dossier

Abaisser le segment du dossier

Relever le segment des pieds

Abaisser le segment des pieds

Relever simultanément les segments du dossier et des pieds

Abaisser simultanément les segments du dossier et des pieds
Abaisser le plan de couchage

Relever le plan de couchage

Relever le moteur de la tête de lit en position Anti-Trendelenburg et abaisser le moteur du pied de lit

Abaisser le moteur de la tête de lit depuis la position Anti-Trendelenburg et relever le moteur du pied de lit

Photo 1

- Trois moteurs et une commande assurent l'articulation du plan de couchage et son réglage en hauteur. Ils doivent rester connectés au secteur pour un fonctionnement continu. Pour garantir ce fonctionnement, le lit peut être équipé en option d'une batterie à utiliser en cas de coupure de courant.
- Pour retirer un moteur (en cas de remplacement), il suffit d'enlever les 2 vis qui le fixent à la structure du lit.
- Évitez de renverser des liquides sur le moteur et la commande.
- Les moteurs répondent aux exigences des directives communautaires relatives à la compatibilité électromagnétique et aux basses tensions ; le niveau sonore est <70 dB(A) (indication du fabricant).
- Les moteurs portent le marquage CE et sont garantis 2 ans contre les défauts de fabrication avérés. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise manipulation du moteur, du câble, de la commande ou de la fiche, ni au non-respect des instructions de montage sur la structure du système de levage et du sommier.
- À la fin de sa durée de vie utile, le moteur électrique doit être remis à un organisme agréé pour l'élimination des déchets conformément à la législation en vigueur.
- Le lit doit être utilisé uniquement à l'intérieur, jamais à l'extérieur ni en plein air.

Après avoir retiré l'emballage, vérifiez tous les composants et, si nécessaire, procédez au montage conformément aux instructions.

CONNEXION DES MOTEURS ET DE LA COMMANDE

Raccorder le moteur de levage du pied de lit

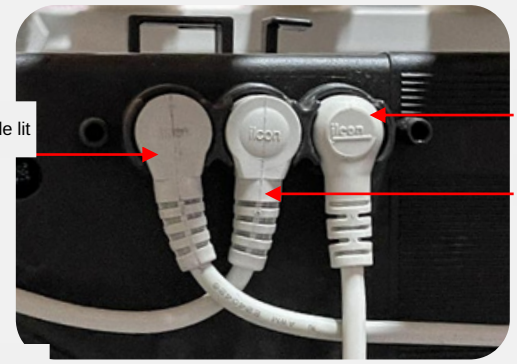

Raccorder la commande

Raccorder le moteur de levage de la tête de lit

Photo 2

POSITIONS POSSIBLES DU LIT

Hauteur minimale - 350 mm



Hauteur maximale - 750 mm



Anti-Trendelenburg



Trendelenburg



Position assise



Position allongée



Dossier relevé



Position vasculaire



Instructions de montage

Schéma 1

1

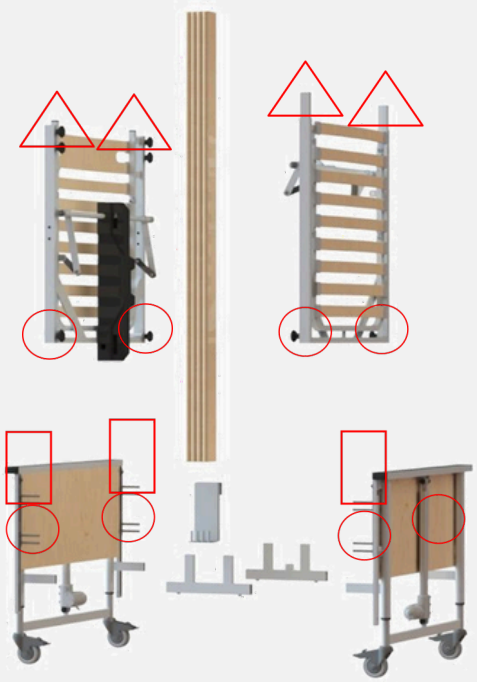

Étape 1
Retirez l'emballage et les pièces 1, 2, 3 et 4. Placez ces pièces dans l'emplacement prévu sous le sommier, près de la tête de lit.

Étape 2
Retirez les 4 pièces du kit de transport.

Étape 3
Assemblez les 2 parties indiquées du sommier.

Insérez les tubes rectangulaires des têtes de lit dans les extrémités indiquées du sommier.

Insérez les 16 bagues rondes dans les 4 lattes indiquées des barrières.

ATTENTION : respectez la position des trous des barrières ; voir le Schéma 2 de cette page.

Étape 4
Ajustez les barrières, le sommier et les têtes de lit en serrant les boutons de fixation correspondants.

Étape 5
Vérifiez le bon fonctionnement des barrières.

Étape 6
Vérifiez le bon fonctionnement des barrières. Branchez la fiche du moteur sur l'alimentation électrique et vérifiez le fonctionnement du moteur, des articulations/du réglage en hauteur et des autres fonctions du lit.

Schéma 2





Dimensions - kit de transport (en millimètres)

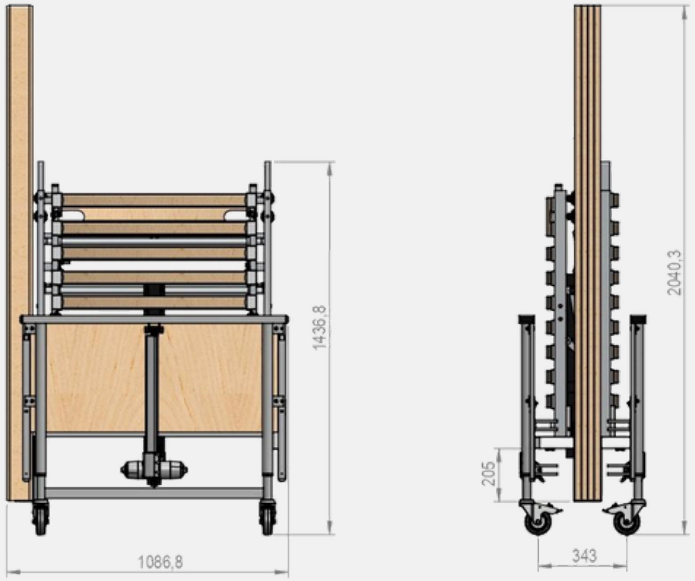



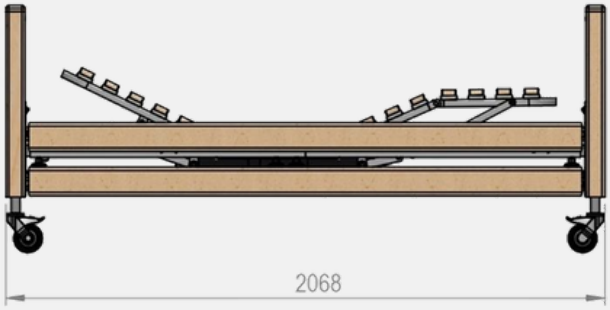

Attention au risque possible d'écrasement des doigts ou des mains dans les parties mobiles :

- Entre la tête de lit lorsqu'elle s'articule et la structure.
- Entre les 4 parties du plan de couchage et le support du sommier.
- Dans l'espace entre les 4 parties du plan de couchage.



Soyez particulièrement attentif à ce symbole. Il est placé près des zones de contact entre deux surfaces, où un écrasement peut se produire en raison du mouvement des sections articulées si les doigts ou les mains se trouvent dans la zone de contact.

Fonctionnement des barrières

Pour abaisser la barrière, soulagez légèrement la barrière supérieure et appuyez sur le bouton situé sur le rail/profil de la tête de lit, en faisant coulisser la barrière vers le bas.
Pour relever les barrières, il suffit de soulever la barrière supérieure jusqu'à entendre un "clic".

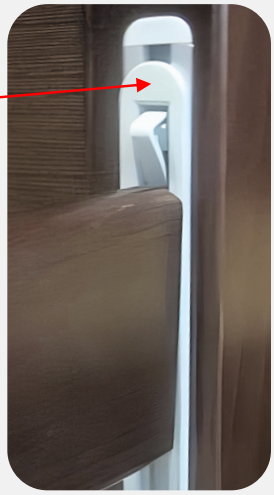



Nettoyage et entretien

- Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux et humide, puis essuyez avec un chiffon sec.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de détergents et/ou de matériaux susceptibles d'endommager ou de rayer le produit.
- Pour les opérations de nettoyage et de désinfection, il est recommandé d'utiliser un produit adapté au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux. La fréquence de nettoyage doit être déterminée en fonction des besoins, du lieu où se trouve le lit et de sa fréquence d'utilisation.
- N'utilisez jamais de stations de lavage automatiques, de lavage en tunnel, d'eau à haute pression ni de pulvérisateurs liquides pendant le nettoyage. Vous risqueriez d'endommager la finition/la peinture.
- N'utilisez pas de solvants tels que le benzène, l'alcool ou des substances similaires !

Emballage et stockage

Le lit Stella est fourni conditionné dans un kit de transport, emballé sous film ou dans du carton. Il suffit de retirer l'emballage puis d'effectuer le montage final conformément au schéma précédent.
Il doit être stocké dans des locaux où la température et l'humidité sont contrôlées (température inférieure à 25 °C, humidité inférieure à 60 %) afin de ne pas endommager l'emballage ni le produit.
Il doit être protégé contre la chute éventuelle d'objets, stocké en position verticale et ne doit pas être empilé.

JMS décline toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation, le non-respect de ces instructions ou d'autres indications, ou par une négligence lors de l'utilisation et de la manipulation du produit.

JMS se réserve le droit d'apporter toute modification à la conception, aux fonctionnalités, à l'esthétique et à la commercialisation de ses produits, à tout moment et sans préavis, ainsi que de mettre à jour ce manuel lorsque cela est nécessaire.

Protection de l'environnement (élimination et recyclage)

JMS accorde une grande importance à la préservation de l'environnement dans toutes ses activités. Nous vous demandons de :
- Trier les déchets d'emballage et les déposer dans les points de collecte correspondants ou les remettre à des opérateurs agréés.
- À la fin de sa durée de vie utile, remettre le produit à un opérateur agréé.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

Merci de votre collaboration !

